

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114

(Page 1)

Cuers, le: 09-03-2014

Attn: Mme. Claire Henrion

Objet: Dépistage DTD-GC/MS systématique sur un (1) échantillon de filaments aéroportés.

Madame,

La prestation analytique que vous nous avez confié sur un échantillon de « filaments aéroportés » est terminée.

Les résultats obtenus sont présentés -en résumé et en détail- dans le rapport analytique ci-dessous.

Cette prestation analytique fait suite à celle réalisée précédemment sur quatre (4) échantillons de « filaments aéroportés » prélevés à l'initiative de plusieurs particuliers en divers lieux répartis dans la France entière. (cf. notre rapport 20131030_Dumas-18_Rapport_analytique_AnalytikA).

Dans le cas présent, l'échantillon provient de la région de Saint Martin de Crau, a été prélevé à la demande de votre adhérente Séverine Laxenaire par les soins de l'étude Bruno, huissier sis à Arles, qui nous l'a transmis le 14 novembre 2014 par colis postal.

Une très grande similitude apparaît clairement entre les résultats obtenus sur cet échantillon (dont l'origine ne saurait être remise en cause puisque la collecte a été réalisée sous contrôle d'huissier) et ceux précédemment collectée par des particuliers sur l'ensemble du territoire national.

Pour extrêmement complexe que soient les résultats observés, la composition des produits de décomposition thermique directe des « filaments aéroportés » étudiés permet de présumer du fait qu'ils résultent d'un processus de polymérisation -dans l'air raréfié en altitude- des effluents de combustion de réacteurs d'aviation.

En effet, parmi les nombreux produits dont le détail est révélé par notre étude, se retrouvent systématiquement un grand nombre de composants chimiques organiques, naturels et synthétiques (en particulier acides gras à longue chaîne et phthalates) susceptibles d'entrer dans la composition des carburants et lubrifiants de ce type de moteurs thermiques à réaction.

L'observation que nous venons de répéter justifie donc pleinement inquiétude dont nous avons fait état lors de la publication de notre premier rapport sur ce sujet, d'autant plus que les observations de retombées de « filaments aéroportés » ne cessent de se multiplier, en France, en Europe et dans le monde entier.

Les connaissances -préliminaires et partielles- que le laboratoire AnAnalytikA est parvenu à obtenir sur la composition de ces « filaments aéroportés » sont **alarmantes** puisqu'il est maintenant **démontré** qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, et que ces retombées sont -inévitables- susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre.

Si **-comme nous le suspectons fortement-** ces retombées de « filaments aéroportés » sont la conséquence du développement du trafic aérien, la responsabilité des fonctionnaires responsables de la surveillance des conséquences sanitaires de ces activités économiques est clairement engagée, de même que celles des fabricants de carburants et lubrifiants d'aviation et des constructeurs de réacteurs d'aviation.

Au même titre que celle liée au trafic automobile, la pollution atmosphérique induite par le transport aérien -- doit être étudiée, surveillée, et réglementée.

Votre association est en mesure de participer à la prise de conscience du grand public et des médias, seuls leviers assez puissants pour susciter une réaction des responsables politiques et de leurs fonctionnaires, dont le silence demeure assourdissant sur le sujet ...

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel.

Bernard TAILLIEZ

Docteur ès Sciences

Directeur Scientifique – Fondateur

Responsable Assurance-Qualité



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112_

131114_ACSEIPICA-12

(Page 2)

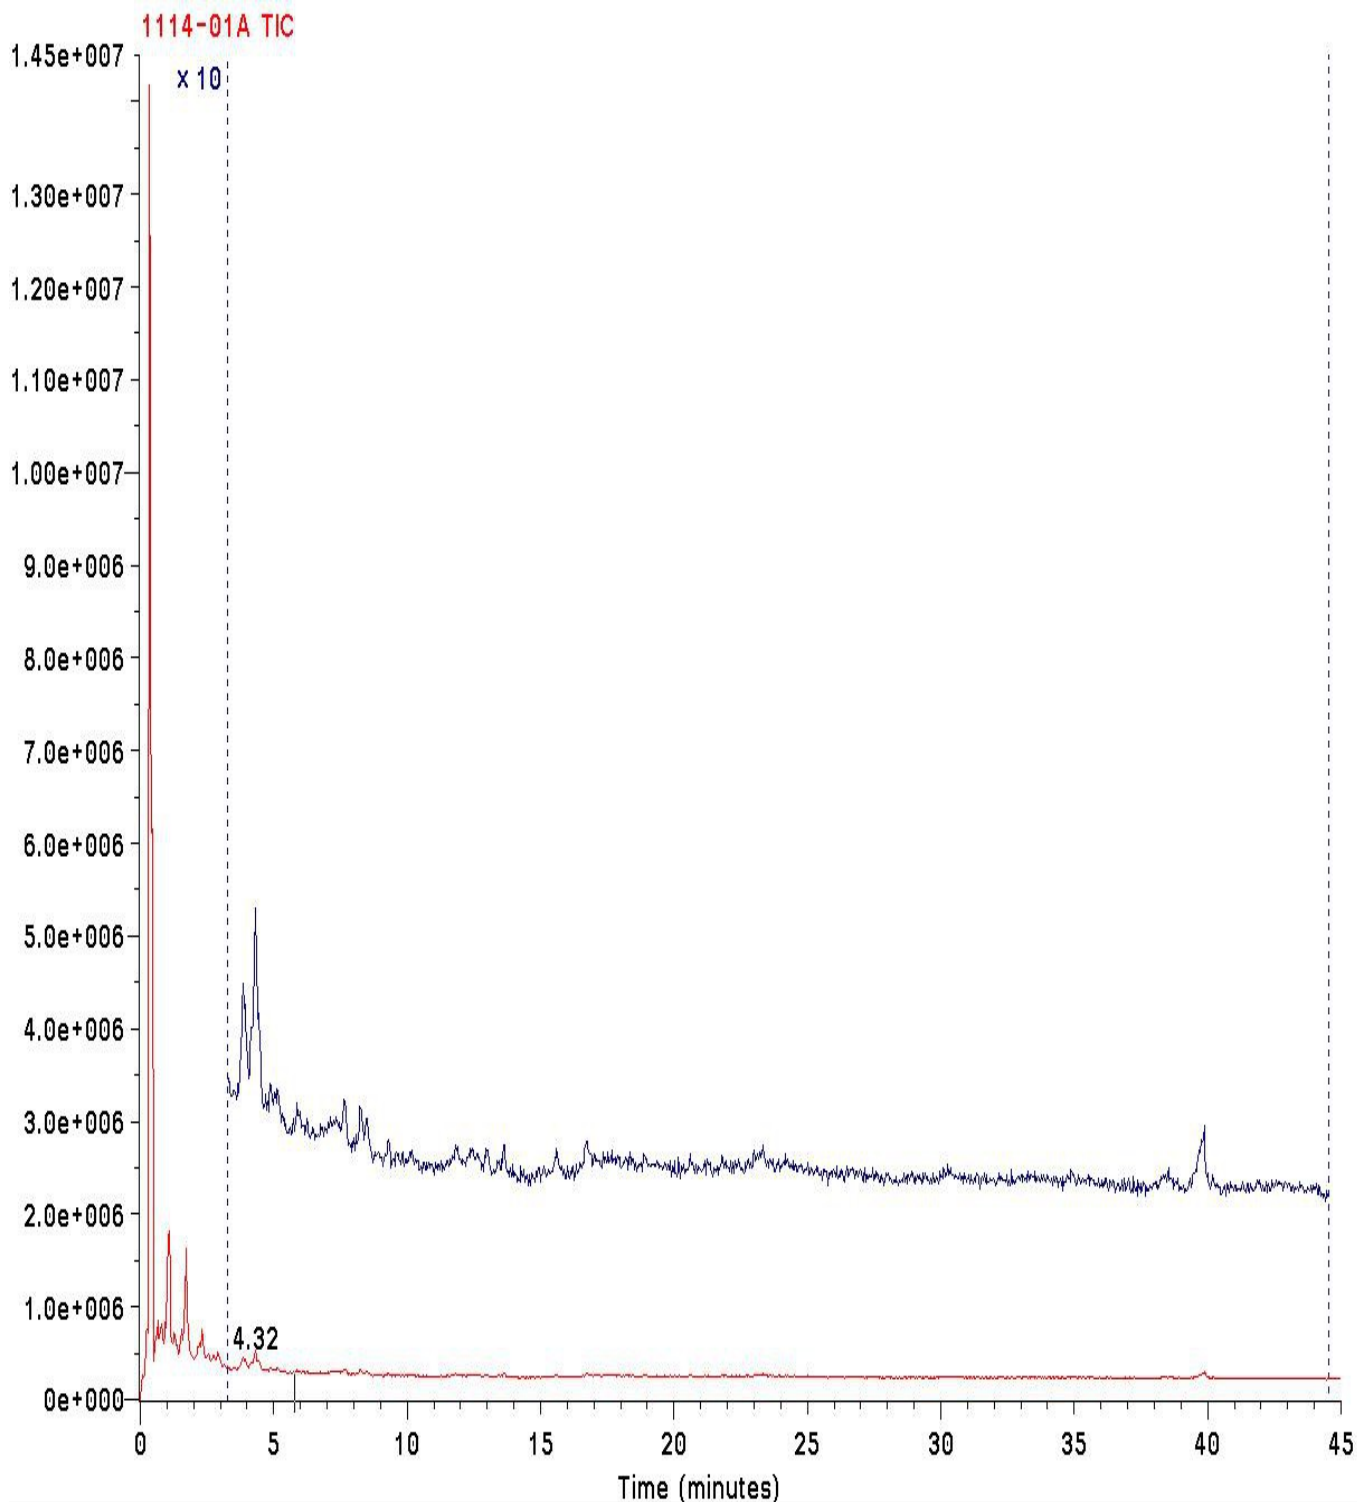


Figure 1
Pyrogramme ionique total



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
ZAC Bousquets - 130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

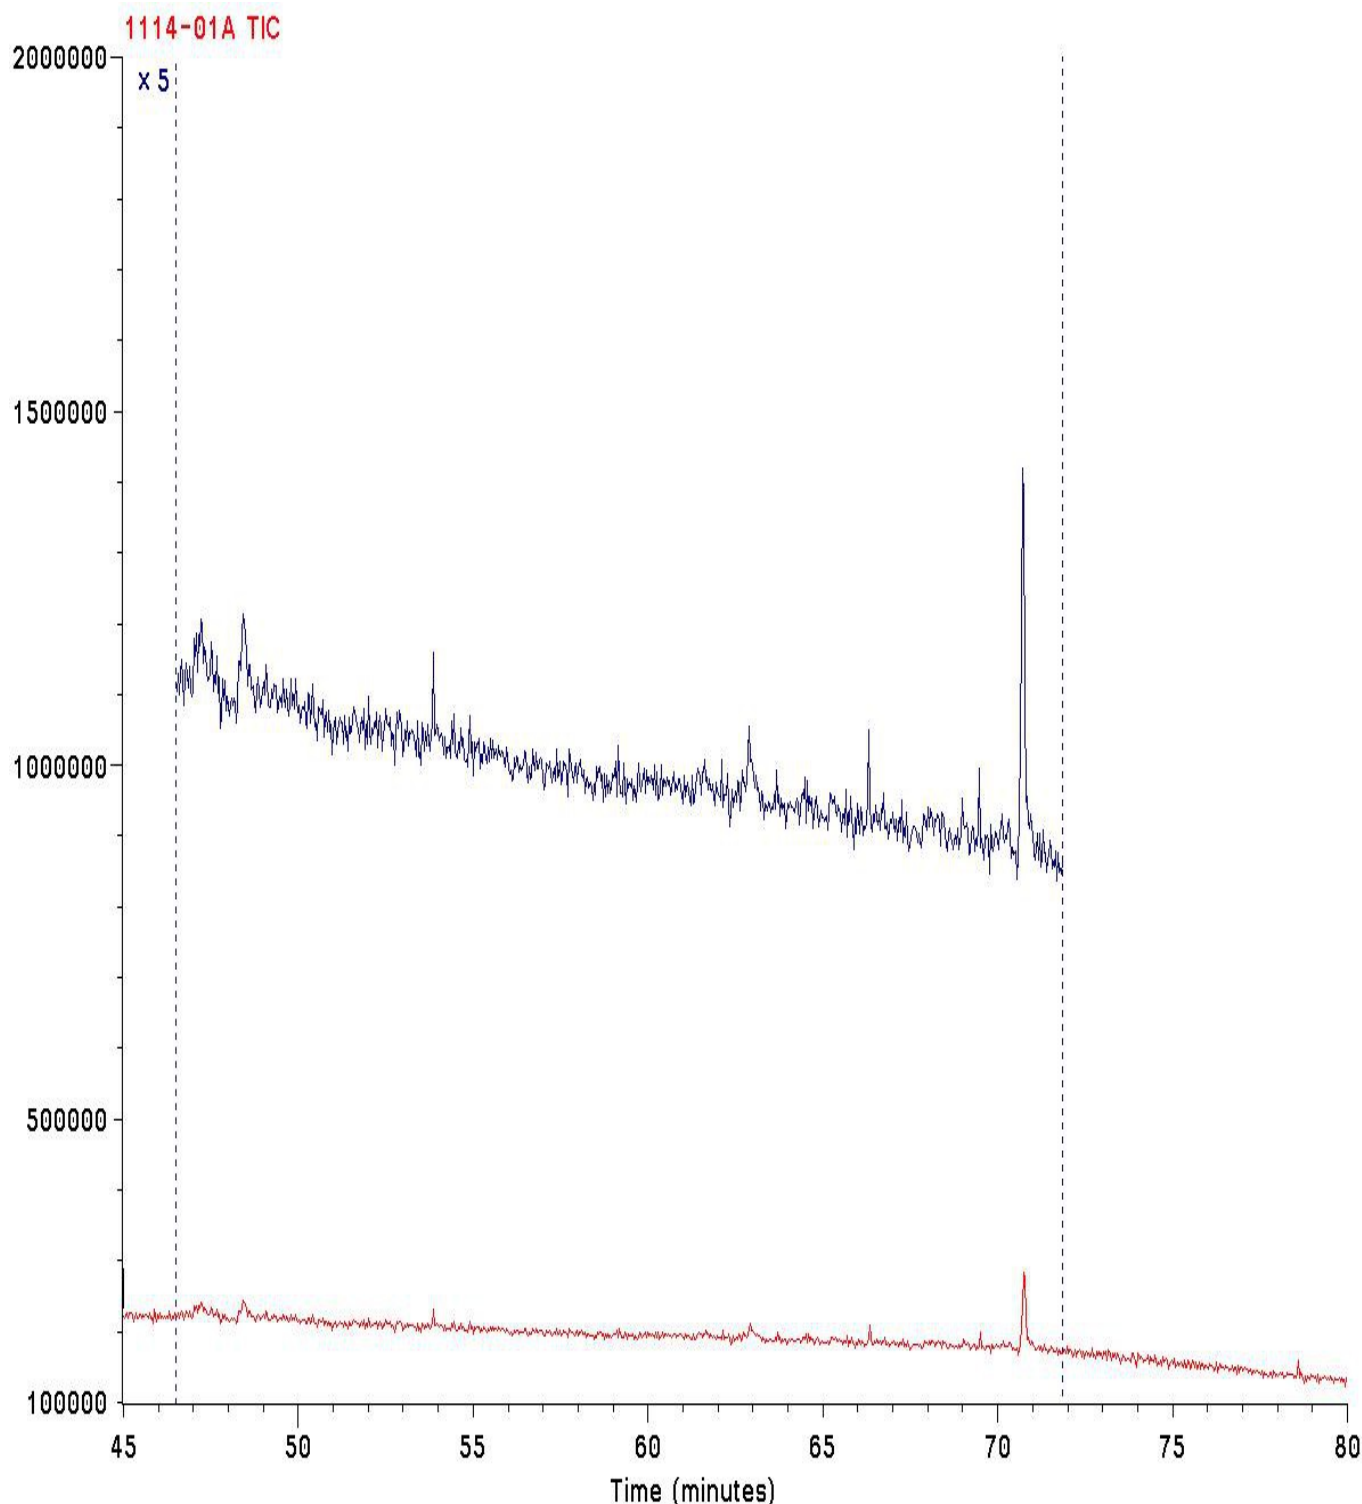


Figure 2
Pyrogramme ionique total



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)




Figure 3
Fragmentogrammes m/z=149 (ion caractéristique des phthalates) & m/z=191 (ion caractéristique de 2,4-di-tert-butylphénol)



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
ZAC Bousquets - 130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

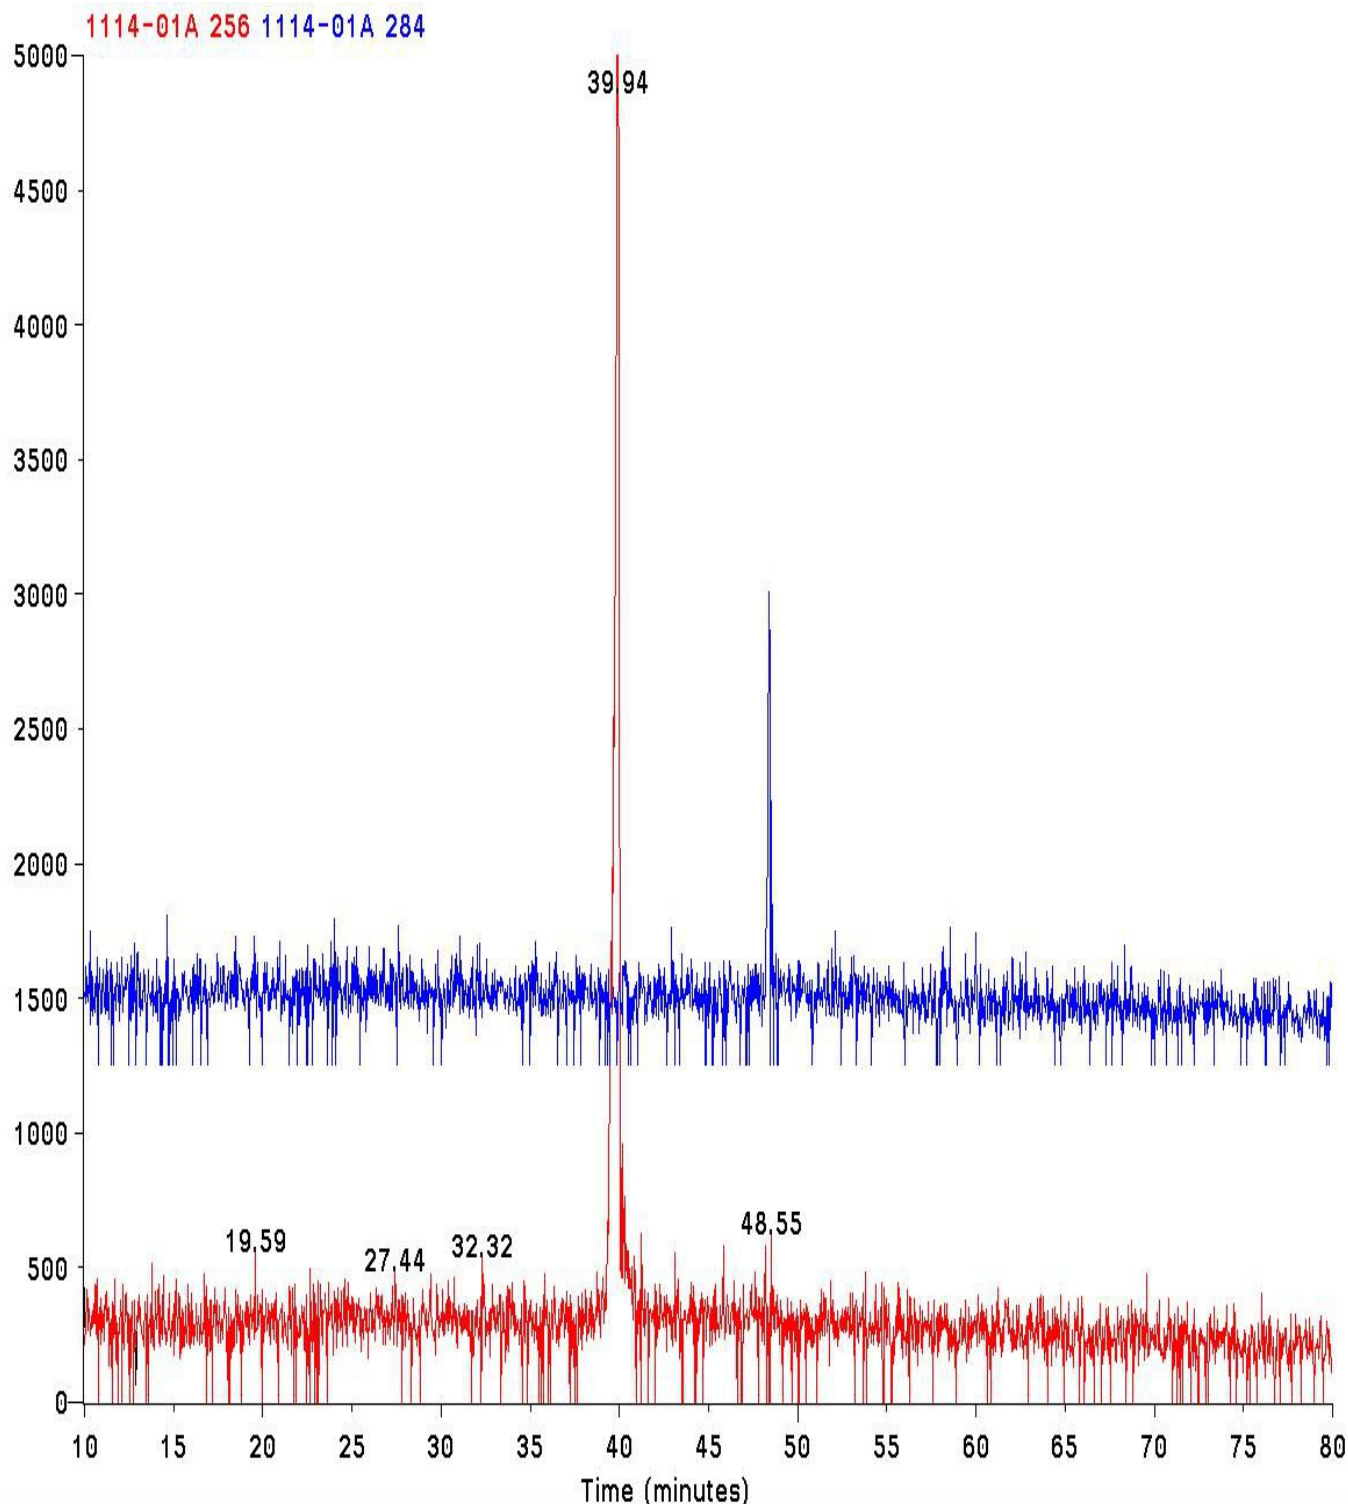


Figure 4
Fragmentogrammes $m/z=256$ (ion caractéristique de hexadecanoic acid) & $m/z=284$ (ion caractéristique de octadecanoic acid)



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
ZAC Bousquets - 130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)




Figure 5
Pyrogramme ionique total & fragmentogramme m/z=94 (ion caractéristique de phenol)



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112_

131114_ACSEIPICA-12

(Page 7)

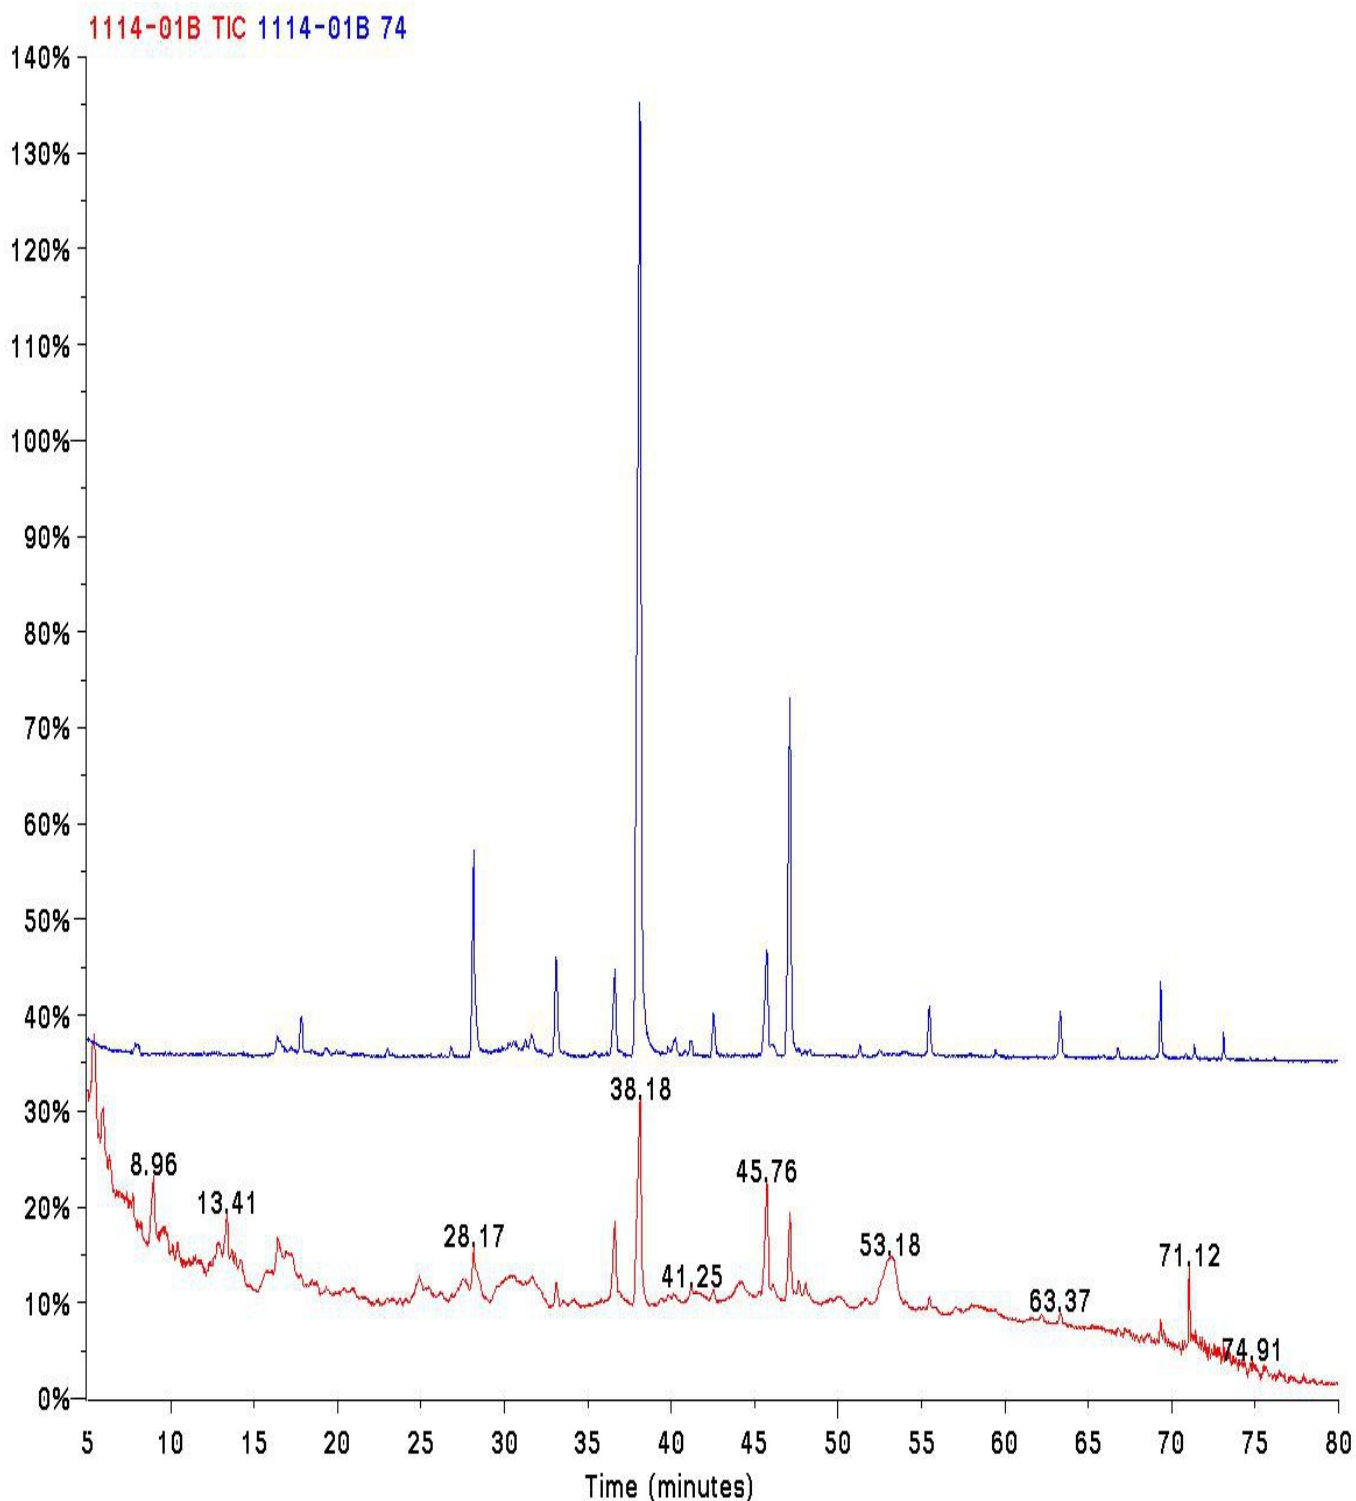


Figure 6
Pyrogramme ionique total & fragmentogramme m/z=74 (ion caractéristique des esters méthyliques)



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
 ZAC Bousquets - 130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
 Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
 Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
 Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112

131114_ACSEIPICA-12

(Page 8)

DEPISTAGE GC/MS SYSTEMATIQUE - Résumé des propositions de similitude**Fichier 1114-01A.TIC**

RT	Name
0.46	Benzene, methyl- (CAS)
0.56-0.59	1H-Pyrrole, 1-methyl- (CAS)
0.65	Styrene
0.79	Propanamide (CAS)
1.08-1.11	Phenol (CAS)
1.18	Benzene, 1,1'-(1-ethenyl-1,3-propanediyl)bis- (CAS)
1.54	Phenol, 4-methyl- (CAS)
1.73	Phenol, 4-methyl- (CAS)
	Phenol, 3-methyl- (CAS)
	Phenol, 2-methyl- (CAS)
1.77	2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (CAS)
2.22	Benzene, (isocyanomethyl)- (CAS)
2.32	Benzeneacetonitrile (CAS)
2.42	Phenol, 2-ethyl- (CAS)
2.52-2.55	Phenol, 2,6-dimethyl- (CAS)
2.91	Phenol, 4-ethyl- (CAS)
	Phenol, 3-ethyl- (CAS)
3.83	2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-
4.15 4.25	Benzeneacetaldehyde (CAS)
4.28-4.35	Benzenepropanenitrile (CAS)
5.13-5.23	Phenol, 2-propyl- (CAS)
5.85-5.95	Benzeneacetonitrile, .alpha.-methylene- (CAS)
6.21-6.25	1H-Indene, 1-hexadecyl-2,3-dihydro- (CAS)
7.10-7.19	phenol, 4-butyl-
7.32-7.39	1,3-Cyclopentanedione (CAS)
16.81	Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)- (CAS)
39.68-39.98	Hexadecanoic acid (CAS)
48.42-48.49	Octadecanoic acid (CAS)
62.77-63.10	1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (CAS)
70.78-70.81	2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (CAS)

Fichier 1114-01B.TIC

RT	Name
4.35	METHYL UNDECANOATE
	METHYL DECANOATE
12.92-13.05	Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- (CAS)
16.33-16.52	1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (CAS)
17.14-17.41	1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (CAS)
17.80	Dodecanoic acid, methyl ester (CAS)
18.13	c-6-thiazole
28.17	Tetradecanoic acid, methyl ester (CAS)
31.21-31.31	Pentadecanoic acid, methyl ester (CAS)
31.57-31.71	Tetradecanoic acid, 12-methyl-, methyl ester (CAS)
33.11	Pentadecanoic acid, methyl ester (CAS)
33.60	Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[4-methoxy- (CAS)
36.48-36.74	11-Hexadecenoic acid, methyl ester (CAS)
38.08	Hexadecanoic acid, methyl ester (CAS)
	Pentadecanoic acid, 14-methyl-, methyl ester (CAS)
42.49-42.69	Heptadecanoic acid, methyl ester (CAS)
45.66	9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester (CAS)
	13-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)- (CAS)
	8-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)- (CAS)
47.10	Octadecanoic acid, methyl ester (CAS)
52.52-53.60	ETHANOL, 2-(P-METHOXYPHENYL)-
55.50	Heneicosanoic acid, methyl ester (CAS)
63.34	Docosanoic acid, methyl ester (CAS)
63.54-63.63	1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (CAS)
66.87	Tetracosanoic acid, methyl ester (CAS)
69.42	Heneicosanoic acid, methyl ester (CAS)
71.02-71.78	2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (CAS)
73.18	cyclopentaneundecanoic acid, methyl ester



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112

131114_ACSEIPICA-12

(Page 9)

DEPISTAGE GC/MS SYSTEMATIQUE - Détail des propositions de similitude

(Spectrothèques de masse de référence WILEY-NBS: 210.000 spectres + NIST-EPA-MSDC: 75.000 spectres + ANALYTIKA: 15.000 spectres)

RT.(min.) Nom chimique (CAS)

RT=Retention Time

Rel = % de similitude


>75%	Identifié
31%<75%	Très probable
10%<30%	Probable
<10%	Possible

_TIC

1114-01A.TIC


RT 0.46 Benzene, methyl- (CAS)

Toluene
CP 25
Methylbenzene
Toluol
Methacide
Antisal 1a
Methylbenzol
Phenylmethane
METHYLBENZENE(TOLUENE)




Serial #129301 CAS #108883
MW 92 Quality 876
C7 H8

1114-01A: Scan 14 (0.46 min) - Back



Benzene, methyl- (CAS)

#129301 Rel:86 CAS #108883 MW:92 C7 H8



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE


CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 10)


RT 0.56-0.59 1H-Pyrrole, 1-methyl- (CAS)

1-Methylpyrrole
N-Methylpyrrole
Pyrrole, 1-methyl-




Serial #157786 CAS #96548
MW 81 Quality 539
C5 H7 N

1114-01A: Scan Avg 17-18 (0.56 - 0.59 min) - Back



1H-Pyrrole, 1-methyl- (CAS)
#157786 Ret:60 CAS #96548 MW:81 C5 H7 N



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE


CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 11)


RT 0.65 Styrene

Ethenylbenzene
vinylbenzene




Serial #221080 CAS #100425
MW 104 Quality 343
C8 H8

1114-01A: Scan 20 (0.65 min) - Back



Styrene
#221080 Rel:86 CAS #100425 Mw:104 C8 H8



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 12)


RT 0.79 Propanamide (CAS)

Propionamide
Propionic amide
Propionic acid amide
Propanimidic acid
Propionimidic acid


Et CONH₂

Serial #67662 CAS #79050
MW 73 Quality 880
C₃H₇N O

1114-01A: Scan 24 (0.79 min) - Back



Propanamide (CAS)
#67662 Rel:39 CAS #79050 MW:73 C₃H₇N O



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RT 1.08-1.11 Phenol (CAS)

Izal
ENT 1814
PhOH
Benzol
Oxybenzene
Monophenol
Phenic acid
Carbolic acid
Phenylic acid
Hydroxybenzene
Phenyl hydrate
Phenyl alcohol
Phenylic alcohol
Phenyl hydroxide
Monohydroxybenzene
Baker's P and S Liquid and Ointment




Serial #68450 CAS #108952
MW 94 Quality 865
C6 H6 O

1114-01A: Scan Avg 33-34 (1.08 - 1.11 min) - Back



Phenol (CAS)

#68450 Rel:95 CAS #108952 MW:94 C6 H6 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence



Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 14)

RT 1.18 Benzene, 1,1'-(1-ethenyl-1,3-propanediyl)bis- (CAS)Serial #29129 CAS #61141977
MW 222 Quality 992
C17 H18

1114-01A: Scan 36 (1.18 min) - Back

Benzene, 1,1'-(1-ethenyl-1,3-propanediyl)bis- (CAS)
#29129 Ret:39 CAS #61141977 Mw:222 C17 H18**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**


RT 1.54 Phenol, 4-methyl- (CAS)

p-Cresol
p-Toluol
4-Cresol
p-Kresol
p-Oxytoluene
p-Methylphenol
p-Cresylic acid
p-Tolyl alcohol
4-Hydroxytoluene
p-Hydroxytoluene
4-Methylphenol
p-Methylhydroxybenzene
1-Hydroxy-4-methylbenzene
1-HYDROXY-4-METHYLBENZENE(4-METHYLPHENOL;P-CRESOL)




Serial #154079 CAS #106445
MW 108 Quality 463
C7 H8 O

1114-01A: Scan 47 (1.54 min) - Back



Phenol, 4-methyl- (CAS)

#154079 Ret:83 CAS #106445 Mw:108 C7 H8 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12

(Page 16)

RT 1.73 Phenol, 4-methyl- (CAS)

p-Cresol
p-Toluol
4-Cresol
p-Kresol
p-Oxytoluene
p-Methylphenol



Serial #154079 CAS #106445
MW 108 Quality 463
C7 H8 O

Phenol, 3-methyl- (CAS)

m-Cresol
Cresol
m-Kresol
3-Cresol
m-Toluol
m-Cresole

Serial #237844 CAS #108394
MW 108 Quality 815
C7 H8 O

Phenol, 2-methyl- (CAS)

o-Cresol
o-Toluol
2-Cresol
o-Oxytoluene
o-Methylphenol
2-Methylphenol


Serial #129599 CAS #95487
MW 108 Quality 874
C7 H8 O

1114-01A: Scan 53 (1.73 min) - Back



Phenol, 4-methyl- (CAS)

#129601 Rel:92 CAS #106445 Mw:108 C7 H8 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 17)


RT 1.77 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (CAS)

Cytosine
 2-OXY-4-AMINOPYRIMIDINE
 Cyt
 Cytosinimine
 4-Amino-2(1H)-pyrimidinone
 4-Amino-2-hydroxypyrimidine




Serial #2644 CAS #71307
 MW 111 Quality 984
 C4 H5 N3 O

1114-01A: Scan 54 (1.77 min) - Back



2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (CAS)
 #2644 Rel:14 CAS #71307 MW:111 C4H5N3O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence



Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 18)

RT 2.22 Benzene, (isocyanomethyl)- (CAS)BENZYLISOCYANIDE
Benzyl isocyanide
Benzyl isonitrileSerial #3700 CAS #10340917
MW 117 Quality 837
C8 H7 N

1114-01A: Scan 68 (2.22 min) - Back

Benzene, (isocyanomethyl)- (CAS)
#3700 Rel:88 CAS #10340917 MW:117 C8 H7 N**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 19)


RT 2.32 Benzeneacetonitrile (CAS)

Benzyl cyanide
 Phenylacetonitrile
 Benzyl nitrile
 .alpha.-Tolunitrile
 2-Phenylacetonitrile
 .omega.-Cyanotoluene
 .alpha.-Cyanotoluene
 Acetonitrile, phenyl-
 (Cyanomethyl)benzene
 Phenacetonitrile
 Benzenediaceonitrile
 BENZYL CYANIDE




Serial #148129 CAS #140294
 MW 117 Quality 780
 C8 H7 N

1114-01A: Scan 71 (2.32 min) - Back



Benzeneacetonitrile (CAS)

#129825 Rel:93 CAS #140294 Mw:117 C8 H7 N

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12


(Page 20)

RT 2.42 Phenol, 2-ethyl- (CAS)


o-Ethylphenol
 1-HYDROXY-2-ETHYLBENZENE
 ORTHO-ETHYLPHENOL
 Phlorol
 2-Ethylphenol
 Phenol, o-ethyl-
 1-Ethyl-2-hydroxybenzene
 3,4 and 2,5 -dimethylphenol



Serial #70169 CAS #90006
 MW 122 Quality 888
 C8 H10 O



Phenol, 2-ethyl- (CAS)
 #70169 Rel:21 CAS #90006 Mw:122 C8 H10 O



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 21)


RT 2.52-2.55 Phenol, 2,6-dimethyl- (CAS)

1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene
 2,6-Dimethylphenol
 2,6-Xylenol
 2,6-Dimethyl-phenol
 2,6-Dimethyl phenol
 1-HYDROXY-2,6-DIMETHYLBENZENE(2,6-DIMETHYLPHENOL)




Serial #237845 CAS #576261
 MW 122 Quality 820
 C8 H10 O

1114-01A: Scan Avg 77-78 (2.52 - 2.55 min) - Back



Phenol, 2,6-dimethyl- (CAS)

#237845 Rel:81 CAS #576261 MW:122 C8 H10 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12

(Page 22)

RT 2.91 Phenol, 4-ethyl- (CAS)


p-Ethylphenol
4-Ethylphenol
Paraethylphenol
Phenol, p-ethyl-
1-Ethyl-4-hydroxybenzene
4-Ethyl-phenol



Serial #151220 CAS #123079
MW 122 Quality 344
C8 H10 O


Phenol, 3-ethyl- (CAS)

m-Ethylphenol
1-HYDROXY-3-ETHYLBENZENE
3-Ethylphenol
Phenol, m-ethyl-
1-Ethyl-3-hydroxybenzene




Serial #129952 CAS #620177
MW 122 Quality 780
C8 H10 O

1114-01A: Scan 89 (2.91 min) - Back



Phenol, 4-ethyl- (CAS)

#151220 Rel:27 CAS #123079 Mw:122 C8 H10 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12

(Page 23)


RT 3.83 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-

2-pyrrolidinone, 1-vinyl-
 n-vinyl-2-pyrrolidinone
 n-vinyl-2-pyrrolidone
 n-vinylpyrrolidinone
 n-vinylpyrrolidone
 vinylbutyrolactam
 vinylpyrrolidinone
 vinylpyrrolidone
 1-vinyl-2-pyrrolidinone
 1-vinyl-2-pyrrolidinone, monomer
 1-vinyl-2-pyrrolidone
 1-vinylpyrrolidinone
 vinyl-2-pyrrolidone
 1-vinylpyrrolidone
 1-ethenyl-2-pyrrolidinone
 V-pyrol




Serial #8922 CAS #88120
 MW 111 Quality 231
 C6H9NO

1114-01A: Scan 117 (3.83 min) - Back



2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-
 #8922 Rel:53 CAS #88120 MW:111 C6H9NO



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RT 4.15-4.25 Benzeneacetaldehyde (CAS)

Hyacinthin
Phenylethanal
Phenylacetaldehyde
.alpha.-Tolualdehyde
Acetaldehyde, phenyl-
Phenylacetic aldehyde
.alpha.-Toluic aldehyde
2-phenyl ethanal




Serial #4020 CAS #122781
MW 120 Quality 996
C8 H8 O

1114-01A: Scan Avg 127-130 (4.15 - 4.25 min) - Back



Benzeneacetaldehyde (CAS)
#4020 Rel:54 CAS #122781 Mw:120 C8 H8 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12

(Page 25)

RT 4.28-4.35 Benzenepropanitrile (CAS)

3-Phenylpropanitrile


Serial #5908 CAS #645590
MW 131 Quality 1000
C9 H9 N

1114-01A: Scan Avg 131-133 (4.28 - 4.35 min) - Back



Benzenepropanitrile (CAS)

#5908 Rel:26 CAS #645590 MW:131 C9 H9 N

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 26)


RT 5.13-5.23 Phenol, 2-propyl- (CAS)

2-N-PROPYLPHENOL
2-NOR-PROPYLPHENOL
2-Propylphenol
o-Propylphenol
Phenol, o-propyl-




Serial #6779 CAS #644359
MW 136 Quality 430
C9 H12 O

1114-01A: Scan Avg 157-160 (5.13 - 5.23 min) - Back



Phenol, 2-propyl- (CAS)
#6779 Rel:31 CAS #644359 MW:136 C9 H12 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12

(Page 27)


RT 5.85-5.95 Benzeneacetonitrile, .alpha.-methylene- (CAS)

.alpha.-Cyanostyrene
 Atroponitrile
 2-Phenylacrylonitrile
 Acrylonitrile, 2-phenyl-
 .alpha.-Phenylacrylonitrile
 ALPHA-CYANOSTYRENE




Serial #5553 CAS #495103
 MW 129 Quality 858
 C9 H7 N

1114-01A: Scan Avg 178-181 (5.82 - 5.92 min) - Back



Benzeneacetonitrile, .alpha.-methylene- (CAS)

#5553 Rel:88 CAS #495103 Mw:129 C9 H7 N

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 28)

RT 6.21-6.25 1H-Indene, 1-hexadecyl-2,3-dihydro- (CAS)

1-N-HEXADECYLINDANE


1-N-HEXADECYLINDAN

1-NOR-HEXADECYL-(2,3-DIHYDROINDENE) (1-NOR-HEXADECYLINDAN)


Serial #145853 CAS #55334297

MW 342 Quality 779

C25 H42




1114-01A: Scan Avg 190-191 (6.21 - 6.25 min) - Back



1H-Indene, 1-hexadecyl-2,3-dihydro- (CAS)

#145853 Rel:39 CAS #55334297 Mw:342 C25 H42

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 29)


RT 7.10-7.19 phenol, 4-butyl-

phenol, p-butyl-
 p-butylphenol
 p-hydroxybutylbenzene
 4-butylphenol
 4-n-butylphenol
 p-n-butylphenol
 1-hydroxy-4-n-butylbenzene
 UN 2228
 UN 2229




Serial #27893 CAS #1638228
 MW 150 Quality 231
 C10H14O

1114-01A: Scan Avg 217-220 (7.10 - 7.19 min) - Back



phenol, 4-butyl-

#27893 Rel:39 CAS #1638228 MW:150 C10H14O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 30)


RT 7.32-7.39 1,3-Cyclopentanedione (CAS)

1,3-Cyclopentadione
CYCLOPENTAN-1,3-DIONE




Serial #79927 CAS #3859414
MW 98 Quality 1000
C5 H6 O2

1114-01A: Scan Avg 224-226 (7.32 - 7.39 min) - Back



1,3-Cyclopentanedione (CAS)
#79927 Ret:21 CAS #3859414 MW:98 C5 H6 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 31)


RT 16.81 Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)- (CAS)

2,4-Di-tert-butylphenol
 2,4-BIS(TERT-BUTYL)-PHENOL
 2,4-Di-t-butylphenol
 Phenol, 2,4-di-tert-butyl-
 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol
 2,4-Di-tert-butyl-phenol
 4-(1,5-Dimethylhex-4-enyl)cyclohex-2-enone
 2,6,6-Trimethyltricyclo[5.3.1.0(5,11)]undecan-8-one
 5-Methyl-8-isopropenyldecahydronaphthalen-2-one
 2,4 DI-TERT-BUTYLPHENOL
 PHENOL 2,4-BIS(1,1,DIMETHYLETHYL)
 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene
 2,4-Bis(tert-butyl)phenol


Serial #159665 CAS #96764

MW 206 Quality 400

C14 H22 O




1114-01A: Scan 514 (16.81 min) - Back



Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)- (CAS)

#159665 Rel:93 CAS #96764 Mw:206 C14 H22 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 32)


RT 39.68-39.98 Hexadecanoic acid (CAS)

Palmitic acid
 Palmitinic acid
 n-Hexadecoic acid
 n-Hexadecanoic acid
 Pentadecanecarboxylic acid
 1-Pentadecanecarboxylic acid
 Prifrac 2960




Serial #237806 CAS #57103
 MW 256 Quality 499
 C16 H32 O2

1114-01A: Scan Avg 1213-1222 (39.68 - 39.98 min) - Back



Hexadecanoic acid (CAS)

#237806 Ret:97 CAS #57103 MW:256 C16 H32 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12


(Page 33)

RT 48.42-48.49 Octadecanoic acid (CAS) $\text{H O}_2 \text{C} (\text{CH}_2)_{16} \text{Me}$


Stearic acid
 n-Octadecanoic acid
 PD 185
 NAA 173
 Vanicol
 Kam 3000
 Kam 1000
 Kam 2000
 Neo-Fat 18
 Steric acid
 Hystrene 80
 Industrine R
 Stearex Beads
 Hystrene S-97
 Neo-Fat 18-53
 Neo-Fat 18-54
 Neo-Fat 18-59
 Neo-Fat 18-55
 Hystrene T-70
 Stearophanic acid
 Humko Industrine R
 Hydrofol Acid 150
 1-Heptadecanecarboxylic acid
 Hystrene S 97
 Hystrene T 70
 Barolub FTA
 Loxiol G 20
 Lunac S 20
 Emersol 153
 Century 1210
 Century 1220

Serial #156693 CAS #57114
 MW 284 Quality 503
 C18 H36 O2

1114-01A: Scan Avg 1480-1482 (48.42 - 48.49 min) - Back



Octadecanoic acid (CAS)
 #133080 Rel:74 CAS #57114 Mw:284 C18 H36 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RT 62.77-63.10 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (CAS)

Bis(2-ethylhexyl) phthalate

DOP

DEHP

DOF

DNOP

Octoil

Fleximel

Sicol 150

Eviplast 81

Staflax DOP

Eviplast 80

VestinolAH

Truflex DOP

Bisoflex81

Witcizer 312

Kodaflex DOP

Palatinol AH

Compound 889

Vinicizer 80

Pittsburgh PX-138

Ethylhexyl phthalate

Diethylhexyl phthalate

2-Ethylhexyl phthalate

Di(Ethylhexyl) phthalate

Di-(2-Ethylhexyl)-phthalate

Phthalic acid dioctyl ester

Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzenedicarboxylate

1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(ethylhexyl) ester

1,2-Benzenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester

Flexol DOP

Di(2-Ethylhexyl) phthalate

Bisoflex DOP

Good-rite GP 264

Ergoplast FDO

Reomol D 79P


Ergoplast FDO-S

Bis(2-ethylhexyl) o-phthalate

DOF (Russian plasticizer)

DI-2-ETHYLHEXYL PHTHALATE

BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE




Serial #78731 CAS #117817

MW 390 Quality 110


C24 H38 O4

1114-01A: Scan Avg 1919-1929 (62.77 - 63.10 min) - Back



1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (CAS)

#78731 Rel:72 CAS #117817 Mw:390 C24 H38 O4

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 35)

RT 70.78-70.81 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (CAS)


Squalene

Skvalen

Supraene

Spinacene

2,6,10,15,19,23-HEXAMETHYL-2,6,10,14,18,22,-TETRACOSAHEXAENE



Serial #133861 CAS #7683649

MW 410 Quality 864


C30 H50

1114-01A: Scan Avg 2164-2165 (70.78 - 70.81 min) - Back



2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (CAS)

#133861 Rel:76 CAS #7683649 MW:410 C30 H50



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 36)

1114-01B.TIC

RT 4.35 METHYL UNDECANOATE


METHYL HENDECANOATE

Serial #240406 CAS #0
MW 200 Quality 895
C12 H24 O2


METHYL DECANOATE

Serial #240405 CAS #0
MW 186 Quality 892
C11 H22 O2

1114-01B: Scan 133 (4.35 min) - Back



METHYL UNDECANOATE
#240406 Rel:28 CAS #0 MW:200 C12 H24 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)


RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 37)

RT 12.92-13.05 Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- (CAS)


4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol

BHT
P 21
CAO 3
AO 29
CAO 1
AO 4K
DBPC
P 21 \$
2,6-DI-TERT-4-METHYLPHENOL
Buks
Ionol
Ionole
Deenax
Dalpac
Stavox
Vianol
Topanol
Ionol 1
Dibunol
Ionol CP
Impruvol
Nonox TBC
Topanol O
Tenox BHT
Vanlube PC
Tenamene 3
Topanol OC
Tranquilan
Tranquilax
Tranisant
Chemanox 11
Ionol
Sustane BHT




Serial #132261 CAS #128370
MW 220 Quality 880
C15 H24 O

1114-01B: Scan Avg 395-399 (12.92 - 13.05 min) - Back



Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- (CAS)

#132261 Rel:42 CAS #128370 MW:220 C15 H24 O

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 38)

RT 16.33-16.52 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (CAS)

Dimethyl terephthalate
 Dimethyl p-phthalate
 Methyl 4-carbomethoxybenzoate
 Terephthalic acid dimethyl ester
 Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate
 Terephthalic acid, dimethyl ester
 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester
 Dimethyl ester of 1,4-benzenedicarboxylic acid
 DIMETHYL TEREPHTHALATE
 DIMETHYLTEREPHTHALATE
 Dimethyl p-benzenedicarboxylate
 Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate
 DMT




Serial #21659 CAS #120616

MW 194 Quality 999


C10 H10 O4

1114-01B: Scan Avg 499-505 (16.33 - 16.52 min) - Back



1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (CAS)

#21659 Rel:95 CAS #120616 Mw:194 C10 H10 O4

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**


RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_

131114_ACSEIPICA-12

(Page 39)


RT 17.14-17.41 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (CAS)

Dimethyl isophthalate
 Methyl isophthalate
 Dimethyl m-phthalate
 Methyl 3-carbomethoxybenzoate
 Isophthalic acid dimethyl ester
 Isophthalic acid, dimethyl ester
 Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate
 1,3-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester
 DIMETHYLISOPHTHALATE
 1,3-dimethoxycarbonyl-benzene




Serial #145127 CAS #1459934
 MW 194 Quality 899
 C10 H10 O4

1114-01B: Scan Avg 524-532 (17.14 - 17.41 min) - Back



1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (CAS)
 #145127 Rel:93 CAS #1459934 Mw:194 C10 H10 O4

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12


(Page 40)

RT 17.80 Dodecanoic acid, methyl ester (CAS)Me(CH₂)₁₀C(O)OMe

Methyl laurate
 Methyl dodecanoate
 Methyl n-dodecanoate
 Lauric acid methyl ester
 Metholene 2296
 Methyl laurate
 Methyl dodecylate
 Uniphat A40 IN 511
 Lauric acid, methyl ester
 Dodecanoic acid methyl ester
 Uniphat A40
 DODECANOIC ACID-METHYL ESTER
 METHYLLAURATE
 Stepan C 40


Serial #145286 CAS #111820
 MW 214 Quality 324
 C13 H26 O2

1114-01B: Scan 544 (17.80 min) - Back



Dodecanoic acid, methyl ester (CAS)

#145286 Rel:68 CAS #111820 MW:214 C13 H26 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 41)


RT 18.13 c-6-thiazoleSerial #42446 CAS #0
MW 167 Quality 0
C9H13NS

1114-01B: Scan 554 (18.13 min) - Back



c-6-thiazole

#42446 Rel:33 CAS #0 MW:167 C9H13NS

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RT 28.17 Tetradecanoic acid, methyl ester (CAS)Me (CH₂)₁₂ C (O) OMe

Methyl myristate
 Methyl tetradecanoate
 Methyl n-tetradecanoate
 Myristic acid methyl ester
 Uniphat A50
 Metholeneat 2495
 Myristic acid, methyl ester
 Tetradecanoic acid methyl ester
 MYRISTIC ACID-METHYL ESTER
 METHYLMYRISTATE


Serial #33523 CAS #124107
 MW 242 Quality 997
 C15 H30 O2

1114-01B: Scan 861 (28.17 min) - Back



Tetradecanoic acid, methyl ester (CAS)

#33523 Rel:95 CAS #124107 Mw:242 C15 H30 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: **_00112_****131114_ACSEIPICA-12**


(Page 43)

RT 31.21-31.31 Pentadecanoic acid, methyl ester (CAS)Me(CH₂)₁₃C(O)OMe

Methyl pentadecanoate
 PENTADECANOIC ACID-METHYL ESTER
 Methyl n-pentadecanoate
 Pentadecanoic acid methyl ester
 Methyl 2-ethyltridecanoate
 methyl pendecanoate


Serial #145489 CAS #7132641
 MW 256 Quality 256
 C16 H32 O2

1114-01B: Scan Avg 954-957 (31.21 - 31.31 min) - Back



Pentadecanoic acid, methyl ester (CAS)

#145489 Rel:38 CAS #7132641 MW:256 C16 H32 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: **+33 4 9428 5980** - Fax: +33 4 9428 5983mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12



(Page 44)

RT 31.57-31.71 Tetradecanoic acid, 12-methyl-, methyl ester (CAS)

Methyl 12-methyltetradecanoate

Serial #36437 CAS #5129668
MW 256 Quality 898
C16 H32 O2

1114-01B: Scan Avg 965-969 (31.57 - 31.71 min) - Back

Tetradecanoic acid, 12-methyl-, methyl ester (CAS)
#36437 Rel:21 CAS #5129668 MW:256 C16 H32 O2**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 45)


RT 33.11 Pentadecanoic acid, methyl ester (CAS)

Methyl pentadecanoate
PENTADECANOIC ACID-METHYL ESTER
Methyl n-pentadecanoate
Pentadecanoic acid methyl ester
Methyl 2-ethyltridecanoate
methyl pendecanoate


 $\text{Me}(\text{CH}_2)_{13}\text{C}(\text{O})\text{OMe}$

Serial #36441 CAS #7132641
MW 256 Quality 998
C16 H32 O2

1114-01B: Scan Avg 1012-1013 (33.11 - 33.14 min) - Back



Pentadecanoic acid, methyl ester (CAS)
#36441 Rel:85 CAS #7132641 MW:256 C16 H32 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**


RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 46)


RT 33.60 Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[4-methoxy- (CAS)

1,2-Bis(p-methoxyphenyl)ethane
 4,4'-Dimethoxybibenzyl
 4,4'-Dimethoxydibenzyl
 Bibenzyl, 4,4'-dimethoxy-
 4,4'-Dimethoxydiphenylethane
 Ethane, 1,2-bis(p-methoxyphenyl)-

Serial #33542 CAS #1657552
 MW 242 Quality 976
 C16 H18 O2




1114-01B: Scan 1027 (33.60 min) - Back



Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[4-methoxy- (CAS)

#33542 Rel:50 CAS #1657552 Mw:242 C16 H18 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 47)

RT 36.48-36.74 11-Hexadecenoic acid, methyl ester (CAS)

METHYL HEXADEC-11-ENOATE




Serial #38798 CAS #55000425

MW 268 Quality 950


C17 H32 O2

1114-01B: Scan Avg 1115-1123 (36.48 - 36.74 min) - Back



11-Hexadecenoic acid, methyl ester (CAS)

#38798 Rel:97 CAS #55000425 MW:268 C17 H32 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>


Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**


RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12

(Page 48)

RT 38.08 Hexadecanoic acid, methyl ester (CAS)

Methyl palmitate
 Methyl hexadecanoate
 Methyl n-hexadecanoate
 Uniphat A60
 Metholene 2216
 Palmitic acid methyl ester
 Palmitic acid, methyl ester
 n-Hexadecanoic acid methyl ester
 PALMITIC ACID-METHYL ESTER
 METHYLPALMITATE


Serial #132941 CAS #112390
 MW 270 Quality 892
 C17 H34 O2

Pentadecanoic acid, 14-methyl-, methyl ester (CAS)


METHYL 14-METHYL-PENTADECANOATE

Serial #76796 CAS #5129602
 MW 270 Quality 877
 C17 H34 O2

1114-01B: Scan 1164 (38.08 min) - Back



Hexadecanoic acid, methyl ester (CAS)
 #76797 Rel:95 CAS #112390 Mw:270 C17 H34 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence



Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 49)

RT 42.49-42.69 Heptadecanoic acid, methyl ester (CAS)Methyl heptadecanoate
Methyl margarate
Margaric acid methyl ester $\text{Me}(\text{CH}_2)_{15}\text{C}(\text{O})\text{OMe}$ Serial #41754 CAS #1731926
MW 284 Quality 1000
C18 H36 O2

1114-01B: Scan Avg 1299-1305 (42.49 - 42.69 min) - Back

Heptadecanoic acid, methyl ester (CAS)
#41754 Rel:92 CAS #1731926 MW:284 C18 H36 O2**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 50)

RT 45.66 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester (CAS)


Methyl oleate
 Methyl cis-9-octadecenoate
 Oleic acid methyl ester
 Oleic acid, methyl ester
 Emery oleic acid ester 2301
 OLEIC ACID-METHYL ESTER
 (Z)-9-OCTADECENOIC ACID, METHYL ESTER



Serial #145687 CAS #112629
 MW 296 Quality 882
 C19 H36 O2

13-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)- (CAS)


CIS-13-OCTADECENOIC METHYL ESTER



Serial #43840 CAS #13058554
 MW 296 Quality 598
 C19 H36 O2


8-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)- (CAS)

TRANS-8-OCTADECENOIC METHYL ESTER
 Methyl trans-8-octadecenoate




Serial #43810 CAS #26528507
 MW 296 Quality 787
 C19 H36 O2

1114-01B: Scan 1396 (45.66 min) - Back



9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester (CAS)
 #145687 Rel:98 CAS #112629 MW:296 C19 H36 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence


Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RT 47.10 Octadecanoic acid, methyl ester (CAS)Me(CH₂)₁₆C(O)OMe


Methyl stearate
 Methyl octadecanoate
 Methyl n-octadecanoate
 Stearic acid methyl ester
 Kemester 9718
 Stearic acid, methyl ester
 n-Octadecanoic acid methyl ester
 Methyl-octadecanoate
 Methyl ester of octadecanoic acid
 METHYL-N-OCTADECANOATE
 methyl stearate
 methyl octadecanoate
 octadecanoic acid methyl ester
 METHYLSTEARATE

Serial #77386 CAS #112618
 MW 298 Quality 999
 C19 H38 O2

1114-01B: Scan 1440 (47.10 min) - Back



Octadecanoic acid, methyl ester (CAS)
 #77386 Rel:97 CAS #112618 Mw:298 C19 H38 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
 ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
 Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
 Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
 Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
 Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**


RT 52.52-53.60 ETHANOL, 2-(P-METHOXYPHENYL)-

Benzeneethanol, 4-methoxy-
Phenethyl alcohol, p-methoxy-
p-Methoxyphenethyl alcohol
.beta.-(p-Methoxyphenyl)ethanol
2-(p-Methoxyphenyl)ethanol
2-(p-Anisyl)ethanol
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
4-Methoxybenzeneethanol
4-Methoxyphenethyl alcohol
p-(Methoxyphenyl)ethyl alcohol

Serial #10568 CAS #702238
MW 152 Quality 1000
C9 H12 O2



ETHANOL, 2-(P-METHOXYPHENYL)-
#10568 Rel:59 CAS #702238 Mw:152 C9 H12 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 53)


RT 55.50 Heneicosanoic acid, methyl ester (CAS)

Methyl heneicosanoate

Me(CH₂)₁₉C(O)OMe


Serial #78106 CAS #6064900
MW 340 Quality 376
C22 H44 O2

1114-01B: Scan 1697 (55.50 min) - Back



Heneicosanoic acid, methyl ester (CAS)

#78106 Rel:92 CAS #6064900 MW:340 C22 H44 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence



Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 54)

RT 63.34 Docosanoic acid, methyl ester (CAS)Methyl behenate
Methyl docosanoate
Behenic acid methyl ester $\text{Me}(\text{CH}_2)_{20}\text{C}(\text{O})\text{OMe}$ Serial #156192 CAS #929771
MW 354 Quality 221
C23 H46 O2

1114-01B: Scan 1937 (63.34 min) - Back

Docosanoic acid, methyl ester (CAS)
#156192 Rel:91 CAS #929771 MW:354 C23 H46 O2**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 55)

RT 63.54-63.63 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (CAS)

Bis(2-ethylhexyl) phthalate

DOP

DEHP

DOF

DNOP

Octoil

Fleximel

Sicol 150

Eviplast 81

Staflax DOP

Eviplast 80

VestinolAH

Truflex DOP

Bisoflex81

Witcizer 312

Kodaflex DOP

Palatinol AH

Compound 889

Vinicizer 80

Pittsburgh PX-138

Ethylhexyl phthalate

Diethylhexyl phthalate

2-Ethylhexyl phthalate

Di(Ethylhexyl) phthalate

Di-(2-Ethylhexyl)-phthalate

Phthalic acid dioctyl ester

Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzenedicarboxylate

1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(ethylhexyl) ester

1,2-Benzenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester

Flexol DOP

Di(2-Ethylhexyl) phthalate

Bisoflex DOP

Good-rite GP 264

Ergoplast FDO

Reomol D 79P


Ergoplast FDO-S

Bis(2-ethylhexyl) o-phthalate

DOF (Russian plasticizer)

DI-2-ETHYLHEXYL PHTHALATE

BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE




Serial #133787 CAS #117817

MW 390 Quality 370


C24 H38 O4

1114-01B: Scan Avg 1943-1946 (63.54 - 63.63 min) - Back



1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (CAS)

#133787 Ret:50 CAS #117817 MW:390 C24 H38 O4

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112_131114 ACSEIPICA-12


(Page 56)

RT 66.87 Tetracosanoic acid, methyl ester (CAS)Me (CH₂)₂₂ C (O) OMe

Methyl lignocerate
 Methyl tetracosanoate
 Lignoceric acid methyl ester
 tetracosanoic (24 : 0)acid methyl ester


Serial #78617 CAS #2442491
 MW 382 Quality 936
 C25 H50 O2

1114-01B: Scan 2045 (66.87 min) - Back



Tetracosanoic acid, methyl ester (CAS)

#78617 Rel:19 CAS #2442491 Mw:382 C25 H50 O2

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com http://www.labo-analytika.com

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 57)


RT 69.42 Heneicosanoic acid, methyl ester (CAS)

Methyl heneicosanoate

Me(CH₂)₁₉C(O)OMe


Serial #78106 CAS #6064900
MW 340 Quality 376
C22 H44 O2

1114-01B: Scan 2123 (69.42 min) - Back



Heneicosanoic acid, methyl ester (CAS)

#78106 Rel:91 CAS #6064900 MW:340 C22 H44 O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUECLIENT: 00112131114 ACSEIPICA-12

(Page 58)

RT 71.02-71.78 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (CAS)


Squalene

Skvalen

Supraene

Spinacene

2,6,10,15,19,23-HEXAMETHYL-2,6,10,14,18,22,-TETRACOSAHEXAENE



Serial #133861 CAS #7683649

MW 410 Quality 864


C30 H50

1114-01B: Scan Avg 2172-2177 (71.02 - 71.18 min) - Back



2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (CAS)

#133861 Rel:83 CAS #7683649 MW:410 C30 H50

**Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique**

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

mailto:info@labo-analytika.com <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : **ISO 17025 (2005)**


RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12


(Page 59)

RT 73.18 cyclopentaneundecanoic acid, methyl ester
methyl dihydrohdnocarbate




Serial #1884 CAS #25779855
MW 268 Quality 0
C17H32O2

1114-01B: Scan 2238 (73.18 min) - Back



cyclopentaneundecanoic acid, methyl ester
#1884 Rel:42 CAS #25779855 Mw:268 C17H32O2



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique

ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France

Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983

<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>

Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B

Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)

RAPPORT ANALYTIQUE

CLIENT: 00112

131114 ACSEIPICA-12

(Page 60)

CONDITIONS EXPERIMENTALES

ECHANTILLONS traités

131114-01 Filaments atmosphériques (20mg, blanc, pot 100mL, prélèvement biologique, plast. transparent, bouchon-vis plast. jaune)
_Réf. client = aucune (prélevé chez Laxenaire-13 Saint Martin de Crau, sous contrôle HUISSIERS-13 Arles (Bruno)

INSTRUMENTATION mise en oeuvre

HR-GC/MS (1000amu)

DONNEES acquises

HP5988L 1000amu EI/CI +/-
Method: (Mon Feb 24 17:22:29 2014) C:\VECTOR2\INSTR1\METHODS\0223-01G.MTH
Cal: C:\VECTOR2\INSTR1\METHODS\150.CAL
Operator: Dr. Bernard Tailliez
HP5 0.25mm_30m_0.25um 80C-(5min)-@2C/min-200C-@5C/min-320CRun=90min DS=0min
INJ=260C DET=320C H2=30mL/min@12psi SL=1.2 Scan=33-400 EMV=3000 THR=0
Scan Parameters:
SCAN every 0 secs for 90 min, base range MS_On 33-400 MS_On

Data: (Mon Feb 24 17:32:15 2014) C:\DATA\ACSEIPICA.12\20131114\1114-01A.TKF
Sample 131114-01 2mg PF590 10sec Account ACSEIPICA-12

Data: (Mon Feb 24 19:30:12 2014) C:\DATA\ACSEIPICA.12\20131114\1114-01B.TKF
Sample 131114-01 7mg + TMAH PF590 20s Account ACSEIPICA-12

TRAITEMENT des ECHANTILLON(S)

Désorption thermique directe @ 590°C

DERIVATISATION

Réactif: TMAH=tetramethyl_ammonium,_hydroxide_CAS75592_
Température (°C) :590
Durée (sec.) : 20

PROTOCOLE ANALYTIQUE appliqué

Interne AnAlytikA

Nos prestations sont réalisées en conformité avec les critères de la norme internationale **ISO 17025 (2005)**
Ceci atteste de notre compétence technique dans les domaines de la chromatographie et de la spectrométrie de masse
ainsi que du bon fonctionnement de notre système interne de management de la qualité.



Centre Indépendant d'Investigations et d'Expertises en Chimie Organique
ZAC Bousquets -130 Rue Innovation / 19 Rue Création 83390 CUERS France
Tel: +33 4 9428 5980 - Fax: +33 4 9428 5983
<mailto:info@labo-analytika.com> <http://www.labo-analytika.com>
Sarl Capital 99.100 € RCS: Toulon B382045219 VAT-FR 62382045219 NAF:743B
Partenaire de l'ADEME et de la Région PACA - Agréé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Norme de fonctionnement : ISO 17025 (2005)




au service des particuliers, associations et entreprises depuis 1991

*Partenaire de l'ADEME, de la Région PACA
et du TGI d'Aix en Provence*

***Le centre Analytika : un acteur innovant
pour toutes investigations de la contamination chimique
des milieux et des produits.***

Pionnier français de l'investigation systématique en chimie analytique, le centre Analytika intervient depuis 1991 au service des entreprises, associations ou particuliers, réalisant le dépistage de tous les contaminants chimiques éventuellement détectables dans les milieux naturels (air, sol, eau), les matières premières, et les produits manufacturés, au-delà de la seule réglementation en vigueur.



1. Structure autonome, privée et totalement indépendante.
2. Centre de recherche doté de puissants moyens analytiques de détection et d'identification.
3. Approche globale et systématique (non-"ciblée") de l'investigation, pour une vision sincère, complète et documentée de l'ensemble des contaminants effectivement présents dans l'échantillon expertisé.

Nos prestations s'adressent donc à quiconque désire connaître précisément et complètement nature et ampleur d'une pollution dont il craint ou suspecte l'existence dans son environnement, quel que soit le cadre dans lequel s'inscrit sa démarche :

- **Particuliers, associations ou collectivités préoccupés de la qualité environnementale** et de la salubrité des lieux de vie et des produits de consommation.
- **Professionnels et industriels éco-responsables soucieux** de la qualité de leurs matières premières et produits finis autant que de l'impact de leurs activités sur l'environnement ou la santé de leurs équipes.

Que votre motivation soit économique, réglementaire, écologique, ou technologique
confiez- vos travaux analytiques
au



Investigation systématique non-"ciblée" de tous les contaminants chimiques détectables dans tous types d'échantillons (sols, eaux, air atmosphérique, produits manufacturés, polymères ou autres) avec identification par recherche de similitude spectrale.

Rapport analytique avec conclusions toxico-chimiques et résultats détaillés (pour chaque molécule détectée, sont fournis : nom chimique CAS et synonymes commerciaux, formule développée graphique et degré % de similitude spectrale).

Structure autonome et indépendante s'appuyant sur des techniques de pointe et un mode opératoire original de dépistage systématique (non-"ciblé"), nos prestations apportent - *au-delà de la seule réglementation en vigueur* - une réponse scientifique sincère, complète et documentée aux préoccupations relatives à la contamination chimique des milieux naturels et des produits manufacturés.

Libre des faiblesses du mode de fonctionnement des laboratoires accrédités, le nouvel éclairage apporté par nos preuves scientifiques complète leurs résultats partiels et les contredit même parfois.

Le centre Analytika poursuit cependant sa mission, convaincu du bien-fondé et de l'utilité sociétale de cette démarche innovante.

Votre contact : Tél.: +33 (0) 6 1866 7432
Bernard Tailliez bernard.tailliez@analytika.fr
Gérant – Fondateur <http://www.analytika.fr>



Accès aux locaux du Centre Analytika

(GPS 43°13'49.76"N - 6°04'57.17"E)

<https://www.google.com/maps/place/Analytika/@43.2303366,6.0828123,18z/data=!4m2!3m1!1s0x12c93dee9f9e9e9f9e:9fb0xc20cf9bf6ba1ab0c/>




Visiteurs : 19 Rue de la Création / Livraisons : 130 Rue de l'Innovation
83390 Cuers (France)

En arrivant de l'ouest (Toulon ou Signes) par RN 97 ou A 57 :

emprunter la **sortie N° 9 Cuers-Sud**, puis à droite en direction de **ZAC des Bousquets** (reste alors à parcourir 1,5 Km environ).
A partir du plan d'orientation de la ZAC (où nous sommes repérés **Laboratoire ANALYTIKA**), longer l'autoroute **Boulevard des Bousquets** pendant 1300 m environ vers l'est et Nice.
Avant le garage **Pôle Auto 83** (hangar bleu), tournez à droite **Rue de l'Innovation**, poursuivez jusqu'au bout de la rue et gardez votre véhicule sur le parking circulaire en bordure de la voie ferrée.

En arrivant du Nord (Brignoles) ou de l'est (Nice) par RN 97 ou A 57 :

emprunter la **sortie N° 10 Cuers-Nord**, puis la **D14** (reste alors à parcourir 2,5 Km environ) en directions de **Cuers - Pierrefeu - Puget Ville**, puis de **Base Aéronavale**, et enfin de **ZAC des Bousquets**.
Après le passage à niveau SNCF, prendre à gauche en direction de **ZAC des Bousquets** et longer l'autoroute **Boulevard des Bousquets** pendant 400 m environ vers l'ouest et Toulon.
Après le garage **Pôle Auto 83** (hangar bleu), tourner à gauche **Rue de l'Innovation**, poursuivre jusqu'au bout de la rue et garer votre véhicule sur le parking circulaire en bordure de la voie ferrée.



Votre contact :
Bernard Tailliez
Gérant – Fondateur

Tél.: +33 (0) 6 1866 7432
bernard.tailliez@analytika.fr
<http://www.analytika.fr>

